

# Kompressionsstrumpskompodium 2024

## Innehåll

Information .....	3
Strumpa antitrombos knä och lår.....	10
Reducering lymfödem.....	11
Binda kompression, kortsträckt och långsträckt samt kohesive (självhäftande) ....	12
Binda kompressionssystem .....	13
Gips/förbandssko .....	14

## Information

Nedanstående strumpor är upphandlade och kompendiet är ett hjälpmedel för er när ni ska beställa.

Strumpor som förskrivs till patient beställs på särskild blankett som mailas till materialdepån. Blanketterna finns nedan, dels för standardstrumpor men även för måttsydda rundstickade och flatstickade. Länk till digitala blanketter:

[Vård \(Itblekinge.org\)](http://Vård (Itblekinge.org))

Ni beställer genom att ange leverantörens artikelnummer på utvald strumpa. Undantaget är Comprinet från Essity som beställs med Sesamnummer.

Har ni frågor om beställningar/leveranser, kontakta materialdepån.

[ic@regionblekinge.se](mailto:ic@regionblekinge.se)

Vid frågor om sortimentet/produkterna kontakta;

Maria Törnkvist

Materialkonsulent Region Blekinge

[maria.tornkvist@regionblekinge.se](mailto:maria.tornkvist@regionblekinge.se)

Tel 0455-736305

Klinik / kostnadsställe

kundnummer

Patientdata

**Beställning kompressionsstrumpor**      **Region Blekinge**

Beställningsnr: \_\_\_\_\_

Artikelnr om beställningsnr ej finns: \_\_\_\_\_

Antal strumpor (par): \_\_\_\_\_

**Modell**

- Knästrumpa med tå  
 Knästrumpa utan tå  
 Lårstrumpa  
 Strumpbyxa

**Kompressionsklass**

- I (18-21 mmHg)  
 II (23-32 mmHg)  
 III (34-46 mmHg)

Kostnadsfritt: ja  nej  Ej kostnadsfria strumpor beställs via Inverdia AB. Se nedan.  
Kostnadsfritt eller ej? Pat. betalar själv vid lindriga, subjektiva besvär o. graviditet.

Ordinatör / läkare: \_\_\_\_\_

Utprovare: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

**Kompressionsklass**

- I (18-21 mmHg)  
II (23-32 mmHg)  
III (34-46 mmHg)

**Indikationer**

Venös insufficiens m. sår, där kl 2 ej fungerar. Hjärtsvikt m. svullnad. Postop. trombosprofylax.  
Venös insufficiens m. eller u. sår. Efter djup ventrombos.  
Kraftig venös insufficiens m. eller u. sår. Lymfödem.

**Kontraindikationer:** Arteriell insufficiens, akut hudinfektion.**Detta blad insändes vid kostnadsfri beställning till Materialdepån (Karlskrona).**Strumpor skickas till beställaren       Strumpor skickas till patienten  Faktura till kommun - adress: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Vid ej kostnadsfri beställning faxas/sänds detta blad till:

Inverdia AB  
Ekbacksv. 20  
168 69 Bromma  
Fax 08-28 58 22

OBS! Med strumpor sänds räkning till  
patienten!

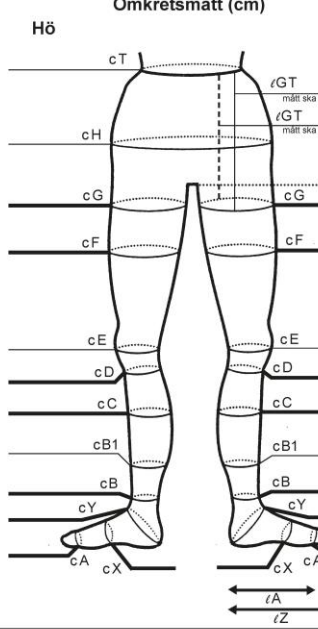
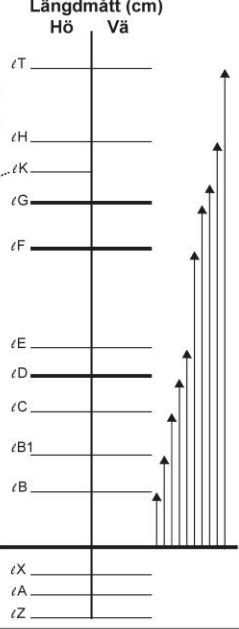
Strumpor skickas till beställaren       Strumpor skickas till patienten

Nybeställning    Ombeställning   **Venosan   Varitex   Venoline**
**INVERDIA AB**  
 Ekbacksv. 20   Tfn 08-6275044  
 168 89 Bromma   Fax 08-285822  
 info@inverdia.com   www.inverdia.com

**Ordnation kompressionsstrumpor (rundstickade)**

Utprovare/beställare		Tjänsteställe		Patient/kund personnummer eller best. nr	
Tfn		E-post		Namn	
Fakturaadress		Leveransadress			
Kostnadsställe		Diagnos		Antal strumpor	
				<input type="text"/> st <input type="text"/> par	
<b>Modell av strumpa</b> <input type="checkbox"/> Knä (AD) <input type="checkbox"/> Byxa (AT) <input type="checkbox"/> Knä (ADH) <input type="checkbox"/> Gravidbyxa (ATM) <input type="checkbox"/> Lär (AGH) <input type="checkbox"/> Lär m midjeband (AGG) <input type="checkbox"/> hö <input type="checkbox"/> vä		<b>Kompressionsklass</b> <input type="checkbox"/> I (18-21 mm Hg) <input type="checkbox"/> II (23-32 mm Hg) <input type="checkbox"/> III (34-46 mm Hg)		<b>Indikationsriktlinjer</b> Lättare ödem, mindre åderbräck, havandeskapsåderbräck Utpräglade ödem/åderbräck, injektionsbeh/kirurgi, bensår, kronisk venös insufficiens Kraftiga ödem/åderbräck, posttrombotiskt syndrom, lymfödem	

**Utprovning**

<b>STANDARDSTORLEKAR</b> (fettlinjemarkerade mått) Knästrumpa 1. Mät med sträckt måttband längden (rD) från fotsula (A) till nivån två fingerbredder nedom knäskålen (D). Obs! Ben rakt, fot i 90° vinkel. 2. Mät omkretsmättet cD. 3. Mät omkretsmättet där vaden är bredast (cC). 4. Mät omkretsmättet där ankeln är smalast (cB). 5. Mät omkretsmättet vid hälen (cY) och tåbasen (cA). 6. Fastställ storlek med storlekstabell (t ex medium) - se produktblad. Lärstrumpa, strumpbyxa 1. Mät med sträckt måttband längden (rF) från fotsula (A) till lärmitt (F). Om hellärsstrumpa eller strumpbyxa önskas mät även till lärslut (G) - obs! ca 5 cm nedom grenen/ljumsken. 2. Mät omkretsmätt vid lärmitt (cF) och eventuellt lärslut (cG). 3. Mät omkretsmätt cD, cC, cB, cY och cA - se knästrumpa. 4. Fastställ storlek med storlekstabell (t ex small) - se produktblad.	<b>Omkretsmått (cm)</b> 	<b>Längdmått (cm)</b> 

A=fotsulan vid tåbasen, X=hålfoten, B=ankels minsta omkrets, B1=nivån där vadmuskeln övergår i akillesenan, C=vadens största omkrets, D=nivån precis nedom tuberositas tibiae (ca två fingerbredder nedom knäskålen - rakt ben), E=mitt över knäskålen och knävecket, F=mellan K och E, G=5 cm nedom K när patienten är slående, H=höftens yttersta punkt, K=grenens mittpunkt (ljumskhöjd), T=midjan, Y=hälsens bakre punkt, Z=yttersta tåns spets

**Beställning (kryssa i alternativ eller ange artikelnummer)**

<b>Venosan</b> <input type="checkbox"/> 4000 <input type="checkbox"/> 6000 <input type="checkbox"/> mexico <input type="checkbox"/> marocco <input type="checkbox"/> mexico <input type="checkbox"/> svart <input type="checkbox"/> svart <input type="checkbox"/> utan tå <input type="checkbox"/> med tå <input type="checkbox"/> med tå <input type="checkbox"/> utan tå	<b>Venoline</b> <input type="checkbox"/> Comp <input type="checkbox"/> beige <input type="checkbox"/> svart <input type="checkbox"/> med tå <input type="checkbox"/> utan tå <input type="checkbox"/> Comp Plus med tå <input type="checkbox"/> beige <input type="checkbox"/> svart <input type="checkbox"/> Comp Cotton beige utan tå	<b>Varitex Prestige</b> <input type="checkbox"/> beige <input type="checkbox"/> svart <input type="checkbox"/> med tå <input type="checkbox"/> utan tå	<b>Silikonband</b> <input type="checkbox"/> dam (AGH) <input type="checkbox"/> neutralt (ADH/AGH)
Artikelnummer			
<b>Hjälpremedel</b> <input type="checkbox"/> Venosan glidsocka (1 utan kostnad per par strumpor) <input type="checkbox"/> Eureka On standard <input type="checkbox"/> Eureka On XL <input type="checkbox"/> Eureka Off <input type="checkbox"/> Hudklister (60 ml)	<input type="checkbox"/> Easy-Slide <input type="checkbox"/> Easy-Slide Magnide <input type="checkbox"/> liten (skonr 34-37) <input type="checkbox"/> stor (skonr 42-45) <input type="checkbox"/> medium (skonr 38-41) <input type="checkbox"/> x-stor (skonr >45)	<input type="checkbox"/> Strumpåtagare metall <input type="checkbox"/> Gummihandskar <input type="checkbox"/> Small/Medium <input type="checkbox"/> small <input type="checkbox"/> Large/X-large <input type="checkbox"/> medium <input type="checkbox"/> Strumpåtagare metall <input type="checkbox"/> large	
<input type="checkbox"/> Faktura till patient <input type="checkbox"/> Patient har godkänt en kostnad på:		kr	Leverans till: <input type="checkbox"/> patient <input type="checkbox"/> sjukvårdsmott.

# Beställning Endast kostnadsförslag Flatstickat



Juzo Scandinavia AB Tel. +46 (0)11 44 222 50 Fax +46 (0)11 44 222 59 E-Mail order@juzo.se

Lymphology

<b>Beställare/ Kundnr. (Texta)</b>		<b>Fakturmottogare (Texta)</b>	
Arb.plats:		Kostnadsställe:	
Adress:		Adress:	
Tel/Fax:		Datum:	
E-mail:		Antal: <input type="checkbox"/> Styck <input type="checkbox"/> Par <input type="checkbox"/> Kvinna <input type="checkbox"/> Man	
<b>Patient</b>			
Namn:		Diagnos:	

## Lymfologi Kryssa för det önskade Bilaga/Foto bifogas i e-mail<sup>2</sup>

<input type="checkbox"/> <b>Vänster ben</b> <input type="checkbox"/> <b>Höger ben</b>		<b>Längd i cm</b> <b>Livdel</b> PKT: _____ PT: _____ Fram: _____ PKT: _____ PHT: _____ Bak: _____	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Material</th> <th>18-21 mmHg</th> <th>23-32 mmHg</th> <th>34-46 mmHg</th> <th>≥ 49 mmHg</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Juzo Expert</td> <td><input type="checkbox"/> KKL 1</td> <td><input type="checkbox"/> KKL 2</td> <td><input type="checkbox"/> KKL 3</td> <td><input type="checkbox"/> KKL 4</td> </tr> <tr> <td>Juzo Expert Silver</td> <td><input type="checkbox"/> 3021</td> <td><input type="checkbox"/> 3022</td> <td><input type="checkbox"/> 3023</td> <td><input type="checkbox"/> 3024</td> </tr> <tr> <td>Juzo Expert Cotton</td> <td><input type="checkbox"/> 3021</td> <td><input type="checkbox"/> 3022</td> <td><input type="checkbox"/> 3023</td> <td><input type="checkbox"/> 3024</td> </tr> <tr> <td>Juzo Expert Strong</td> <td><input type="checkbox"/> 3051</td> <td><input type="checkbox"/> 3052</td> <td><input type="checkbox"/> 3053</td> <td><input type="checkbox"/> 3054</td> </tr> <tr> <td>Juzo Expert Strong Silver</td> <td><input type="checkbox"/> 3051</td> <td><input type="checkbox"/> 3052</td> <td><input type="checkbox"/> 3053</td> <td><input type="checkbox"/> 3054</td> </tr> <tr> <td>Juzo Expert Strong Cotton</td> <td><input type="checkbox"/> 3051</td> <td><input type="checkbox"/> 3052</td> <td><input type="checkbox"/> 3053</td> <td><input type="checkbox"/> 3054</td> </tr> </tbody> </table>	Material	18-21 mmHg	23-32 mmHg	34-46 mmHg	≥ 49 mmHg	Juzo Expert	<input type="checkbox"/> KKL 1	<input type="checkbox"/> KKL 2	<input type="checkbox"/> KKL 3	<input type="checkbox"/> KKL 4	Juzo Expert Silver	<input type="checkbox"/> 3021	<input type="checkbox"/> 3022	<input type="checkbox"/> 3023	<input type="checkbox"/> 3024	Juzo Expert Cotton	<input type="checkbox"/> 3021	<input type="checkbox"/> 3022	<input type="checkbox"/> 3023	<input type="checkbox"/> 3024	Juzo Expert Strong	<input type="checkbox"/> 3051	<input type="checkbox"/> 3052	<input type="checkbox"/> 3053	<input type="checkbox"/> 3054	Juzo Expert Strong Silver	<input type="checkbox"/> 3051	<input type="checkbox"/> 3052	<input type="checkbox"/> 3053	<input type="checkbox"/> 3054	Juzo Expert Strong Cotton	<input type="checkbox"/> 3051	<input type="checkbox"/> 3052	<input type="checkbox"/> 3053	<input type="checkbox"/> 3054
Material	18-21 mmHg	23-32 mmHg		34-46 mmHg	≥ 49 mmHg																																	
Juzo Expert	<input type="checkbox"/> KKL 1	<input type="checkbox"/> KKL 2	<input type="checkbox"/> KKL 3	<input type="checkbox"/> KKL 4																																		
Juzo Expert Silver	<input type="checkbox"/> 3021	<input type="checkbox"/> 3022	<input type="checkbox"/> 3023	<input type="checkbox"/> 3024																																		
Juzo Expert Cotton	<input type="checkbox"/> 3021	<input type="checkbox"/> 3022	<input type="checkbox"/> 3023	<input type="checkbox"/> 3024																																		
Juzo Expert Strong	<input type="checkbox"/> 3051	<input type="checkbox"/> 3052	<input type="checkbox"/> 3053	<input type="checkbox"/> 3054																																		
Juzo Expert Strong Silver	<input type="checkbox"/> 3051	<input type="checkbox"/> 3052	<input type="checkbox"/> 3053	<input type="checkbox"/> 3054																																		
Juzo Expert Strong Cotton	<input type="checkbox"/> 3051	<input type="checkbox"/> 3052	<input type="checkbox"/> 3053	<input type="checkbox"/> 3054																																		
<b>Övriga tillval</b> <input type="checkbox"/> Förflektering Ange knäveck "PE": _____ <input type="checkbox"/> Trikkåfoder vid Ange knäveck "PE": _____ <input type="checkbox"/> Sömmarna utåt		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Vänster ben</th> <th>Höger ben</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PG: _____</td> <td>PG: _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(För strumpbyxa till gren)</td> </tr> <tr> <td>PF: _____</td> <td>PF: _____</td> </tr> <tr> <td>PE: _____</td> <td>PE: _____</td> </tr> <tr> <td>PD: _____</td> <td>PD: _____</td> </tr> <tr> <td>PC: _____</td> <td>PC: _____</td> </tr> <tr> <td>PB: _____</td> <td>PB: _____</td> </tr> <tr> <td>PB: _____</td> <td>PB: _____</td> </tr> </tbody> </table>	Vänster ben	Höger ben	PG: _____	PG: _____	(För strumpbyxa till gren)		PF: _____	PF: _____	PE: _____	PE: _____	PD: _____	PD: _____	PC: _____	PC: _____	PB: _____	PB: _____	PB: _____	PB: _____																		
Vänster ben	Höger ben																																					
PG: _____	PG: _____																																					
(För strumpbyxa till gren)																																						
PF: _____	PF: _____																																					
PE: _____	PE: _____																																					
PD: _____	PD: _____																																					
PC: _____	PC: _____																																					
PB: _____	PB: _____																																					
PB: _____	PB: _____																																					
<b>Tädel</b> <input type="checkbox"/> Tå <input type="checkbox"/> Öppen <input type="checkbox"/> Slutet <input type="checkbox"/> Förflektering fotled <input type="checkbox"/> Snedskuren tädel <input type="checkbox"/> Trikkåfoder vid "cY" <input type="checkbox"/> Pelletter <input type="checkbox"/> Dr. Rotter <input type="checkbox"/> Malleopelletter <input type="checkbox"/> Fastklisrad <input type="checkbox"/> Lös <input type="checkbox"/> Med läggsgicka <input type="checkbox"/> Vänster <input type="checkbox"/> På insidan <input type="checkbox"/> På utsidan <input type="checkbox"/> Höger <input type="checkbox"/> På insidan <input type="checkbox"/> På utsidan		<b>Modell</b> <input type="checkbox"/> AD <input type="checkbox"/> AF <input type="checkbox"/> AG <input type="checkbox"/> Byxa (AT) <input type="checkbox"/> Bermuda <input type="checkbox"/> ET <input type="checkbox"/> FT <input type="checkbox"/> Capri <input type="checkbox"/> BT <input type="checkbox"/> B'T <input type="checkbox"/> CT <input type="checkbox"/> Strumpbyxa ett ben																																				
<b>Övriga tillval</b> <input type="checkbox"/> Förlängning <input type="checkbox"/> Förlängning max <input type="checkbox"/> Förlängning front AF/AG <input type="checkbox"/> Silikonband AD 3,5 cm <input type="checkbox"/> 5 cm <input type="checkbox"/> Silikonband 5 cm (AF/AG) <input type="checkbox"/> Dekorsilikon (5 cm) <input type="checkbox"/> Silikonband balans smal 3,5 cm (AD) <input type="checkbox"/> 5 cm <input type="checkbox"/> Silikonband balans 5 cm (AF/AG) <input type="checkbox"/> Dekorsilikon balans 5 cm <input type="checkbox"/> Spetsilikon 5 cm <input type="checkbox"/> Stickat avslut <input type="checkbox"/> Elastiskt kantband AD (3,5 cm, utan silikon) <input type="checkbox"/> Insidan isydd silikonrand (Endast med förlängning) <input type="checkbox"/> ¾ isydd silikonrand (Endast med förlängning) <input type="checkbox"/> Silikonrandstopper <input type="checkbox"/> Yttersidan <input type="checkbox"/> Fram <input type="checkbox"/> Höftdel (Ange omfång "cT") <input type="checkbox"/> Vänster <input type="checkbox"/> Höger <input type="checkbox"/> Används parvis <input checked="" type="checkbox"/> <b>Stickade vid läret</b> <input type="checkbox"/> Forosa från "cD"		<b>Färger</b> Om inget anges levereras färg Almond. Cotton och Silver endast Almond. Mer information om färgsortiment finns på www.juzo.se Ange: _____ <b>Trend Colour</b> - <b>Batik Collection</b> <input type="checkbox"/> Batik-Vit <input type="checkbox"/> Batik-Svart <b>Dip Dye Collection</b> <input type="checkbox"/> Blueberry <input type="checkbox"/> Poppy seed <b>Strumpa kant/fixering</b> <input type="checkbox"/> Förlängning <input type="checkbox"/> Förlängning max <input type="checkbox"/> Förlängning front AF/AG <input type="checkbox"/> Silikonband AD 3,5 cm <input type="checkbox"/> 5 cm <input type="checkbox"/> Silikonband 5 cm (AF/AG) <input type="checkbox"/> Dekorsilikon (5 cm) <input type="checkbox"/> Silikonband balans smal 3,5 cm (AD) <input type="checkbox"/> 5 cm <input type="checkbox"/> Silikonband balans 5 cm (AF/AG) <input type="checkbox"/> Dekorsilikon balans 5 cm <input type="checkbox"/> Spetsilikon 5 cm <input type="checkbox"/> Stickat avslut <input type="checkbox"/> Elastiskt kantband AD (3,5 cm, utan silikon) <input type="checkbox"/> Insidan isydd silikonrand (Endast med förlängning) <input type="checkbox"/> ¾ isydd silikonrand (Endast med förlängning) <input type="checkbox"/> Silikonrandstopper <input type="checkbox"/> Yttersidan <input type="checkbox"/> Fram <input type="checkbox"/> Höftdel (Ange omfång "cT") <input type="checkbox"/> Vänster <input type="checkbox"/> Höger <input type="checkbox"/> Används parvis <input checked="" type="checkbox"/> <b>Stickade vid läret</b> <input type="checkbox"/> Forosa från "cD"																																				
<b>Standardstorlek</b> <b>Flatstickat</b> Material: <input type="checkbox"/> Juzo Expert (AD Knästrum por) Storlek: <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 Sida: <input type="checkbox"/> Vänster <input type="checkbox"/> 3Höger		<b>Tillval AT</b> <input type="checkbox"/> Sned version (standard) <input type="checkbox"/> Stegform <input type="checkbox"/> Slipform Matth med kardborre (Endast KKL 1) <input type="checkbox"/> Vänster <input type="checkbox"/> Höger <input type="checkbox"/> Midjeband <input type="checkbox"/> Midjeband med kardborre <input type="checkbox"/> Justerbart midjeband <input type="checkbox"/> Silikonband (5 cm) <input type="checkbox"/> Resårkant <input type="checkbox"/> Livdel KKL 1 <input type="checkbox"/> Silikonbandstopper <input type="checkbox"/> Yttersidan <input type="checkbox"/> Fram Livdel med (öppning mitt fram, ej i kombination med justerbart midjeband) <input type="checkbox"/> Dragkedja <input type="checkbox"/> Öglor/krokar <input type="checkbox"/> Kardborre Grenkil <input type="checkbox"/> Nät-grenkil <input type="checkbox"/> Grenkil <input type="checkbox"/> Liten <input type="checkbox"/> Nät-grenkil <input type="checkbox"/> Liten <input type="checkbox"/> Öppning <input type="checkbox"/> Scrotum <input type="checkbox"/> Nät-scrotum																																				
Speciella önskemål (Texta): _____ _____ _____		<b>Snedskuren tädel (Ange "PA")</b> Innsida: _____ Utsida: _____																																				

<sup>1</sup> Genom att ange patientens namn bekräftar det beställande företaget att den berörda patienten har lämnat sitt lagenliga samtycke till att dessa uppgifter vidarebefordras och behandlas.  
<sup>2</sup> Mot bakgrund av dataskyddsprincipen om att vara sparsam med information rekommenderar vi dig att endast skicka in fotodokumentation om det gäller komplicerade anatomiska förhållanden.

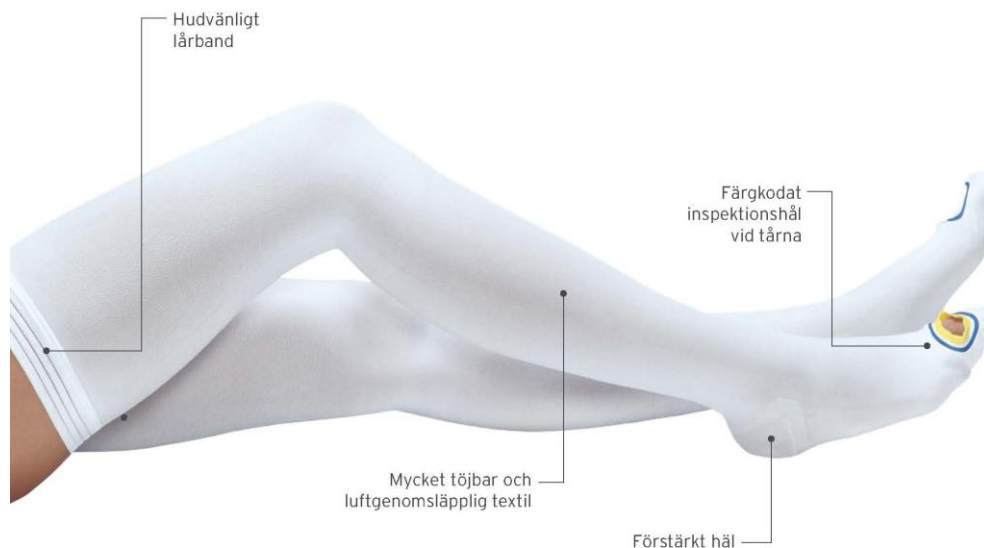


SWE 4407102/01\_86511Y\_08/2019\_Med reservation för produktförändringar och tryckfel.

# Comprinet® pro

## Antitrombosstrumpa

Längs- och tvärelastisk antitrombosstrumpa i mjuk textil med graderad kompression. Den anatomiska utformningen och höga elasticiteten gör att Comprinet pro passar majoriteten av benstorlekar och former. En avancerad stickteknik gör att strumpan bibehåller sin graderade kompression och goda passform. Hela strumpan är i ett stycke utan söm. Latexfri. Tvättbar i maskin i 90° upp till 10 gånger utan att kompressionen påverkas.



### Användningsområde

För trombosprofilax i samband med operation och längre tids immobilisering. Kan användas upp till fyra veckor, därefter övergång till en kompressionsstrumpa klass 1. Kompression ankel 14-22 mmHg.

### Kontraindikationer

Obehandlad arteriell insufficiens, akut hudinflammation, hudinfektioner, hjärtsvikt.


### Innehåll

**Lårstrumpa:**  
74 % polyamid, 20 % elastan, 6 % neopren (kanten)

**Knästrumpa:**  
74 % polyamid, 26 % elastan. Latexfri.

## Instruktion

Hur du trär på strumpan utan att det bildas veck:



1 Stoppa in handen i strumpan och ta tag i hälen.



2 Vänd strumpan ut och in hela vägen ner till hälen. Håll kvar i hälen.



3 Sätt på strumpan fram till hälen. Inspektionshålet ska vara på ovensidan av foten.



4 Dra försiktig upp strumpan på vaden, precis som på en vanlig strumpa.



5 För den överlappande delen över hälen.



6 Vik strumpan neråt och dra sedan uppåt utan kraft.



7 Kontrollera att hälen sitter på rätt plats och utan veck.



8 Kontrollera att inspektionshålet är på rätt ställe och helt öppet.



9 Dra upp strumpan. Vid lårstrumpa: Dra upp strumpan över hela låret.



10 Se till att lårbandet sitter korrekt och utan veck.



11

















# Måttabeller

För att strumpan ska passa användaren och ge en så god medicinsk effektivitet som möjligt är det viktigt att mäta rätt. Korrekt måtttagning säkerställer också bättre komfort och följsamhet hos användaren.



## Knästrumpa

Art nr	Storlek	Färg	 Omfång, ankel	 Omfång, vad	 Längd, vad	Färgkod	Antal/tp	Antal/trp
77026-00	1 Small/normal	Vit	16-19 cm	23-30 cm	-43 cm		10 par	40 par
77027-00	2 Medium/normal	Vit	19-24,5 cm	30-38 cm	-43 cm		10 par	40 par
77028-00	3 Large/normal	Vit	24,5-29 cm	38-46 cm	-43 cm		10 par	40 par
77124-00	4 X-Large/normal	Vit	29-32 cm	46-53 cm	-43 cm		10 par	40 par
77133-00	5 XX-Large/normal	Vit	29-32 cm	53-66 cm	-43 cm		10 par	40 par

## Lårstrumpa

Art nr	Storlek	Färg	 Omfång, ankel	 Omfång, vad	 Omfång, lår	 Längd lår till gluteal	Färgkod	Antal/tp	Antal/trp
46335-00	1 Small/Normal	Vit	16-19 cm	23-30 cm	39-74 cm	64-80 cm		10 par	40 par
46336-00	2 Small/Lång	Vit	16-19 cm	23-30 cm	39-74 cm	80-97 cm		10 par	40 par
46337-00	3 Medium/Normal	Vit	19-24,5 cm	30-38 cm	45-80 cm	64-80 cm		10 par	40 par
46338-00	4 Medium/Lång	Vit	19-24,5 cm	30-38 cm	45-80 cm	80-97 cm		10 par	40 par
46388-00	5 Large/Normal	Vit	24,5-29 cm	38-46 cm	50-86 cm	64-80 cm		10 par	40 par
46389-00	6 Large/Lång	Vit	24,5-29 cm	38-46 cm	50-86 cm	80-97 cm		10 par	40 par
77125-00	7 X-Large/Normal	Vit	29-32 cm	46-53 cm	55-90 cm	64-80 cm		10 par	40 par
77128-00	8 X-Large/Lång	Vit	29-32 cm	46-53 cm	55-90 cm	80-97 cm		10 par	40 par
77130-00	9 XX-Large/Normal	Vit	29-32 cm	53-66 cm	55-90 cm	64-80 cm		10 par	40 par
77131-00	10 XX-Large/Lång	Vit	29-32 cm	53-66 cm	55-90 cm	80-97 cm		10 par	40 par

## Höftmodell/lårstrumpa

Art nr	Storlek	Färg	 Omfång, ankel	 Omfång, vad	 Omfång, lår	 Längd lår till gluteal	Färgkod	Antal/tp	Antal/trp
79611-02	1 Small/Normal	Vit	16-19 cm	23-30 cm	39-74 cm	64-80 cm		5 par	20 par
79612-02	2 Small/Lång	Vit	16-19 cm	23-30 cm	39-74 cm	80-97 cm		5 par	20 par
79613-02	3 Medium/Normal	Vit	19-24,5 cm	30-38 cm	45-80 cm	64-80 cm		5 par	20 par
79614-02	4 Medium/Lång	Vit	19-24,5 cm	30-38 cm	45-80 cm	80-97 cm		5 par	20 par
79615-02	5 Large/Normal	Vit	24,5-29 cm	38-46 cm	50-86 cm	64-80 cm		5 par	20 par
79616-02	6 Large/Lång	Vit	24,5-29 cm	38-46 cm	50-86 cm	80-97 cm		5 par	20 par

## Strumpa antitrombos knä och lår.

### Comprinet Pro

Artikel	Beskrivning	Best.nr Raindance	Lager förd	Leverantörens art.nr
Strumpa antitrombos knä,	Small Vit, kkl1	11493	Ja	77026-00000
Strumpa antitrombos knä,	Medium Vit, kkl1	11494	Ja	77027-00000
Strumpa antitrombos knä,	Large Vit, kkl1	11497	Ja	77028-0000
Strumpa antitrombos knä,	X-large Vit, kkl1	18539	Nej	77124-00000
Strumpa antitrombos knä,	XX-large Vit, kkl1	32220	Nej	77133-00000
Strumpa antitrombos lår lång	Small Vit, kkl1	11710	Ja	46336-00000
Strumpa antitrombos lår lång	Medium Vit, kkl1	11712	Ja	46338-00000
Strumpa antitrombos lår lång	Large Vit, kkl1	11714	Ja	46389-00000
Strumpa antitrombos lår lång	X-large Vit, kkl1	18538	Ja	77128-0000
Strumpa antitrombos lår lång	XX-large Vit, kkl1	19764	Ja	77131-00000
Strumpa antitrombos lår normal	Small Vit, kkl1	11709	Ja	46335-00000
Strumpa antitrombos lår normal	Medium Vit, kkl1	11711	Ja	46337-00000
Strumpa antitrombos lår normal	Large Vit, kkl1	11713	Ja	46388-00000
Strumpa antitrombos lår normal	X-large Vit, kkl1	32219	Nej	77125-00000
Strumpa antitrombos lår normal	XX-large Vit, kkl1	19763	Ja	77130-0000

## Reducering lymfödem

### Thuasne Scandinavia AB

Artikel	Beskrivning	Best.nr Rai dance	Lager förd	Fabrikat
Bandage reducering lymfödem med pelotter	Mobiderm Ark 20x100cm/15x15mm	19789		Mobiderm
Bandage reducering lymfödem med pelotter	Mobiderm Ark 25x100cm/5x5mm	20835		Mobiderm
Bandage reducering lymfödem med pelotter	Mobiderm Bandage 10x300cm/15x15mm	19790		Mobiderm

## Binda kompression, kortsträckt och långsträckt samt kohesive (självhäftande)

### Essity Hygiene and Health AB

Artikel	Beskrivning	Best.nr Rai dance	Lager förd	Fabrikat
Binda kompression kortstäckt, Comprilan	8cm x 5m	11409		JOBST
Binda kompression kortstäckt, Comprilan	10cm x 5m	11410		JOBST
Binda kompression kortstäckt, Comprilan	12cm x 5m	11411		JOBST
Binda kompression långstäckt, Elodur	8cm x 7m	11413		JOBST
Binda kompression långstäckt, Elodur	10cm x 7m	11414		JOBST
Binda kompression långstäckt, Elodur	12cm x 7m	11416		JOBST
Binda kompression kohesive (självhäftande)	10cm x 8m beige	20405		Co-Plus

## Binda kompressionssystem

Artikel	Beskrivning	Best.nr Raidance	Leverantör	Fabrikat
Binda kompressionssystem Comprifore	18-25cm 4-lager	30702	Essity Hygiene and Health AB	JOBST
Binda kompressionssystem Comprifore Lite	18-25 cm 3-lager	15177	Essity Hygiene and Health AB	JOBST
Binda kompressionssystem	PROFORE<18 cm	32335	Smith & Nephew AB	Smith+Nephew
Binda kompressionssystem	PROFORE 25-30cm	32336	Smith & Nephew AB	Smith+Nephew
Binda kompressionssystem	PROFORE>30 cm	14614	Smith & Nephew AB	Smith+Nephew
Binda kompressionssystem	2-lagers AAI>0,5 10cmx3,2m osträckt	19655	3M Svenska AB	Coban 2
Binda kompressionssystem	2-lagers AAI>0,8 10cmx3,5m osträckt	18532	3M Svenska AB	Coban 2
Binda kompressionssystem	2-lagers AAI>0,8 15cmx4,5 m osträckt	34330	3M Svenska AB	Coban 2

## Gips/förbandssko

Artikel	Beskrivning	Best.nr Raidance	Leverantör	Fabrikat
Sko vid gips/kompressionsbehandling	Barn	20834	Lohmann & Rausher AB	Cellona Shoe
Sko vid gips/kompressionsbehandling	X-small	20863	Lohmann & Rausher AB	Cellona Shoe
Sko vid gips/kompressionsbehandling	Small	18036	Lohmann & Rausher AB	Cellona Shoe
Sko vid gips/kompressionsbehandling	Medium	18037	Lohmann & Rausher AB	Cellona Shoe
Sko vid gips/kompressionsbehandling	Large	18038	Lohmann & Rausher AB	Cellona Shoe
Sko vid gips/kompressionsbehandling	X-large	18288	Lohmann & Rausher AB	Cellona Shoe